





## CHECK-LIST INTUBATION ORO-TRACHÉALE

1. **Moniteur actif et opérationnel** : capteur de SpO2 en place, opérationnelle
2. **Sonde d'intubation testée et préparée**
  1. Test d'étanchéité du ballonnet réalisé et concluant
  2. Lubrification avec XYLOSPRAY® opérée à l'intérieur comme à l'extérieur
  3. Mandrin semi rigide en place (si demandé), mandrin long béquillé (dit de Eichmann) disponible
3. **Manche de laryngoscopie** : intégrité vérifiée, lame montée, diffusion de lumière en bout de lame
4. **Oxygène** : bloc d'O2 disposant d'une autonomie satisfaisante, issue d'oxygène après ouverture du bloc
5. **BAVU** : opérationnel (y compris valves unidirectionnelles), remplissage du réservoir après alimentation
6. **Aspirateur à mucosités**
  1. Actif et opérationnel : dépression après mise sous tension
  2. Sonde d'aspiration intra-trachéale montée, sonde intra-buccale disponible à proximité
7. **Respirateur** : testé, en état de fonctionnement, programmé avant intubation
8. **Drogues**
  1. Induction préparée : hypnotique, curare si besoin
  2. Entretien préparé, PSE testés et opérationnels : sédation et analgésie

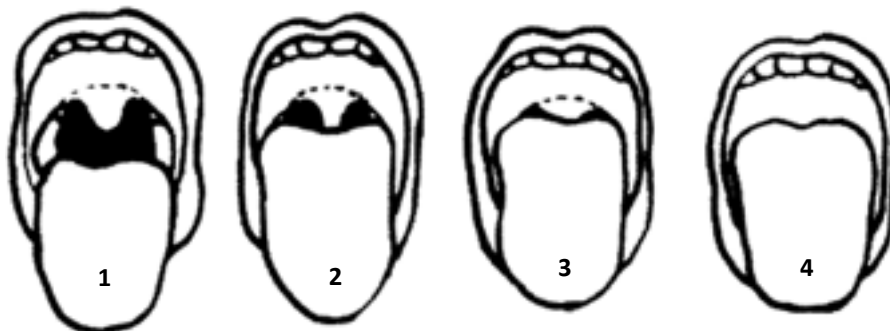

Score de Mallampati

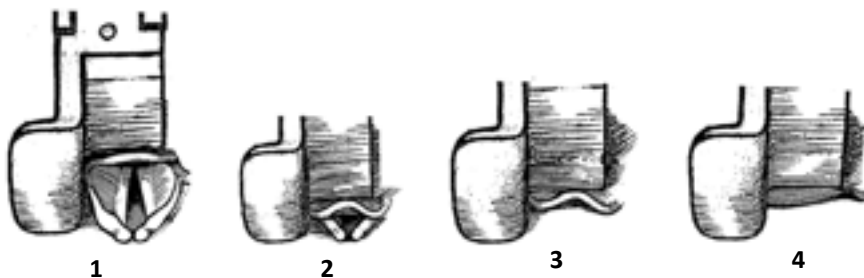

Score de Cormack

### LORS DE TOUTE INTUBATION OROTRACHÉALE, PRÉCISER :

LA TAILLE DE LA SONDE ET DE LA LAME UTILISÉES  
LE SCORE DE MALLAMPATI ET DE CORMACK  
LA DISTANCE ENTRE L'ORIFICE ET LES ARCADES DENTAIRES SUPÉRIEURES